



2023-06-01

Dnr X23-90335
LI2023/01973Landsbygds- och
infrastrukturdepartementet

Yttrande över kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelseers effekt inom unionen

De ovanstående förslagen har inte remitterats till Rättsmedicinalverket, men mot bakgrund av den rättskemiska verksamhet som myndigheten bedriver – som bl.a. avser analyser av blod i samband med misstanke om rattfylleri och drograttfylleri – avges ändå följande yttrande.

I artikel 15.2 anges i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2561 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG och kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 framgår följande.

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om påföljder för nya förare som kör med en alkoholhalt i blodet som överstiger 0,0 g/ml och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Dessa påföljder ska vara effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande.


I regeringskansliets faktrapromemoria 2022/23:FPM69 Omarbetat körkortsdirektiv anges också följande. Under provotiden råder en nolltolerans mot att köra med alkohol i blodet och möjlighet för medlemsstaterna att sätta andra nationella villkor.

Generellt sett har kemiska analysmetoder alltid en osäkerhet som gör att man inte kan mäta ända ned till noll. Tillämpningen av nolltolerans är därför beroende av mätmetoden. Rättsmedicinalverkets metodik kan inte med säkerhet mäta alkoholhalter i blodet som understiger 0,1000 promille (mg/gram). I praktiken är svarsgränsen ännu något högre (0,1111 promille) då ett säkerhetsavdrag baserat på metodens mätosäkerhet görs på samtliga resultat som överstiger 0,1000 promille. Resultat som avser lägre alkoholhalter anses med hänsyn till metodens osäkerhet inte vara tillförlitliga. Vi bedömer att tillämpning av nolltolerans för alkohol i blodet väl kan uppfyllas med metodik vilken med säkerhet kan mäta 0,1000



promille i blodet. Rättsmedicinalverket kan mot bakgrund av vad som anförts ovan inte tillstyrka det framförda förslaget avseende noll som angivet gränsvärde.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Lars Werkström. Föredragande har varit verksjuristen Olof Larsson. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anton Svensson, enhetschefen Fredrik Kugelberg och chefstoxikologen Robert Kronstrand deltagit.

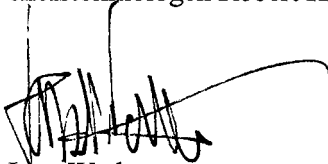

Lars Werkström



Olof Larsson